

## 包装変更のお知らせ


このたび下記対象製品の包装変更を行いますので、ご案内申し上げます。

### 変更内容の概要

販売名	包装	統一商品コード	変更内容	変更ロット (出荷予定時期)
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター	x 1	246779012	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デバイスラベルの貼付位置・サイズを変更します</li> <li>・ピロー袋を廃止し、紙トレイに変更します</li> <li>・会社ロゴを変更します</li> </ul>	EA7L-A (2022年12月中旬)
ベンリスタ皮下注 200mgシリンジ	x 1	246779029	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ピロー袋を廃止し、紙トレイに変更します</li> <li>・会社ロゴを変更します</li> </ul>	未定 (2023年4月)

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

### 変更内容の詳細（オートインジェクター）

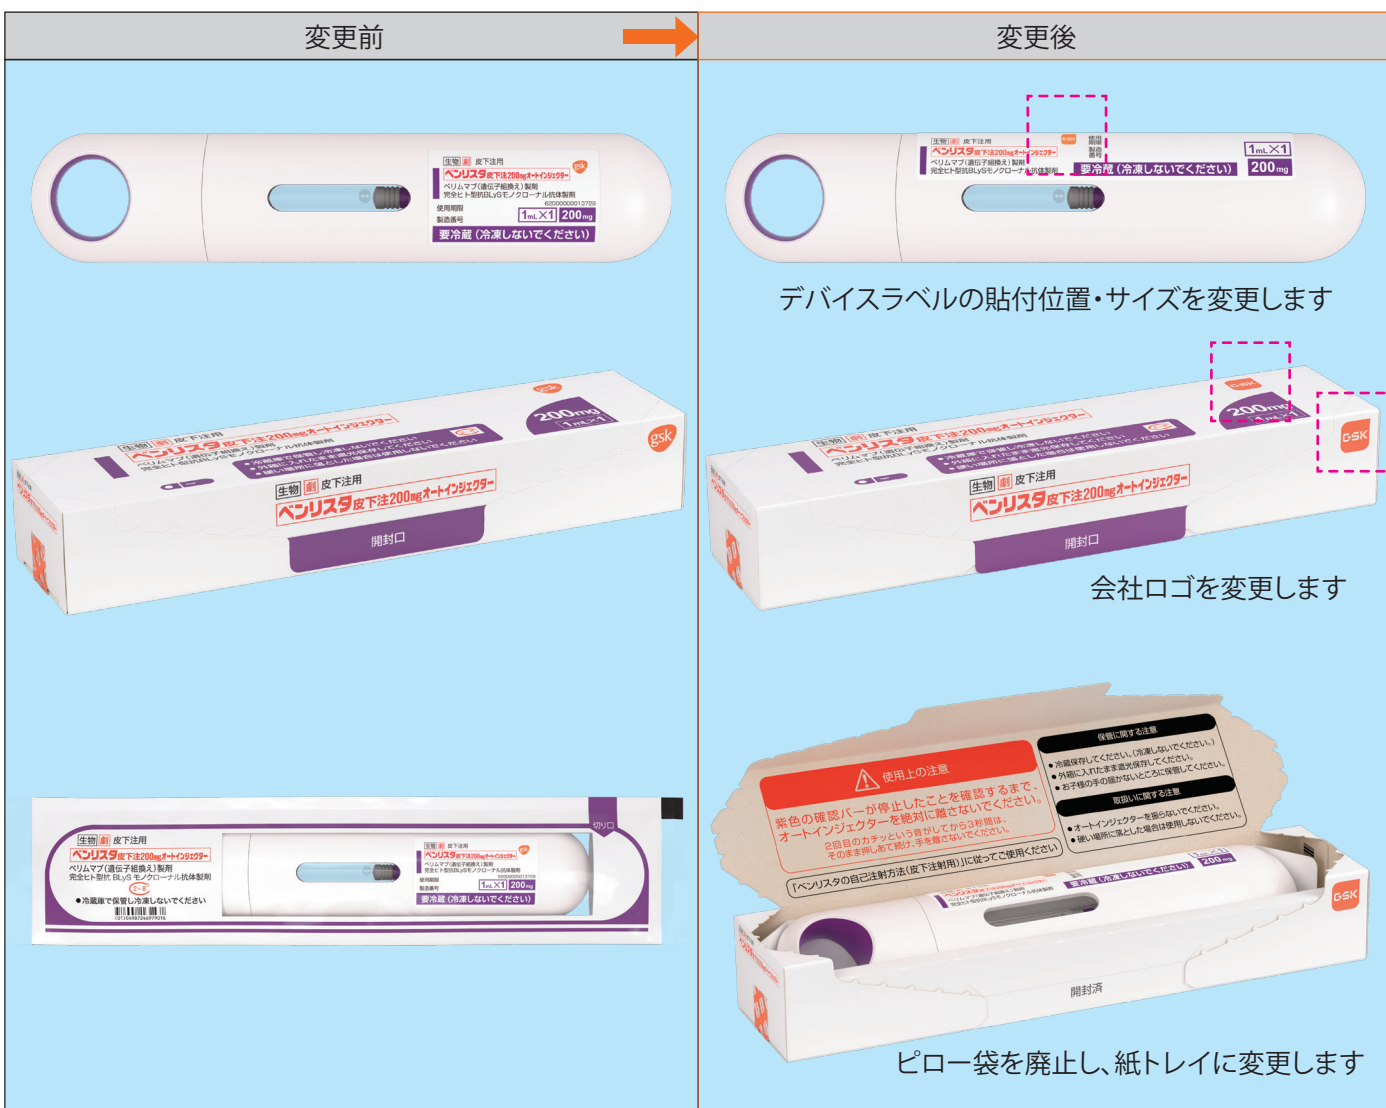


デバイス、カートンのサイズ変更はありません  
うら面もご覧ください

## 変更内容の詳細 (シリンジ)



## サポート資料

サポート資料は、弊社資料ダウンロード・配送サービスからご利用いただけます。

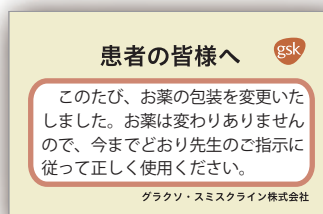

包装変更案内カード



<https://gskpro.com/ja-jp/resource/guidance-for-patients/>  
の疾患/包装からご利用いただけます。

## 最新の包装変更のお知らせについて

最新の Packaging Information は、弊社ホームページの包装変更のお知らせからご確認いただけます。



<https://gskpro.com/ja-jp/products-info/revision/package/>  
からご確認いただけます。

**グラクソ・スミスクライン株式会社**